



Messwertblock 23 – „Schaltzeitabweichung“ der PD-Einheiten :

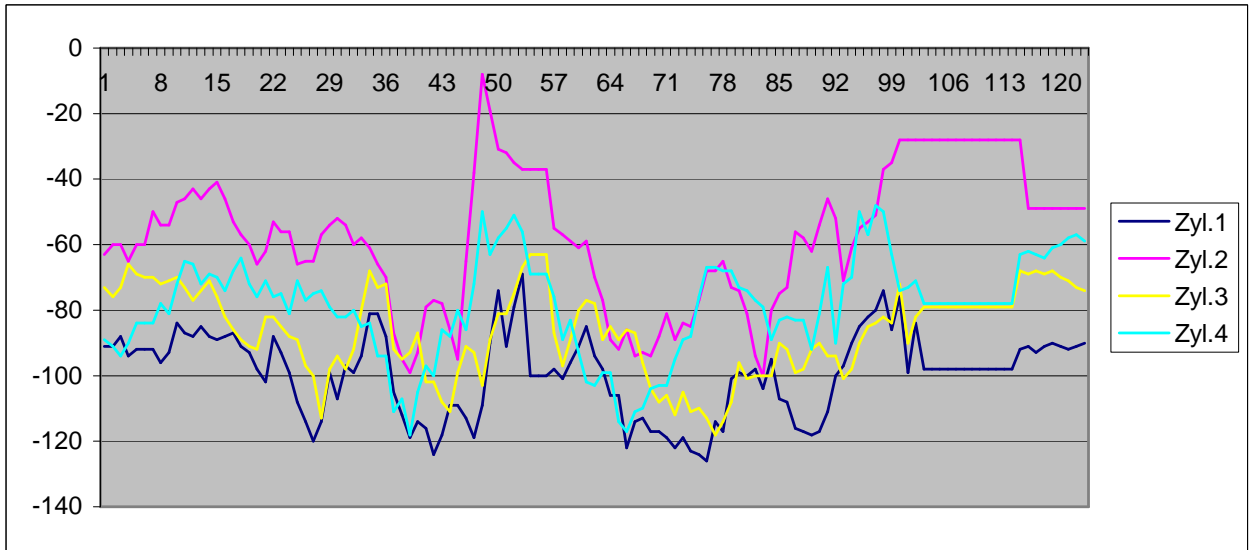

Zyl. 2 : (Max-Wert = -8 ; Min-Wert = -100)

Messwertblock 018 – Status PD-Elemente (Soll = 0)

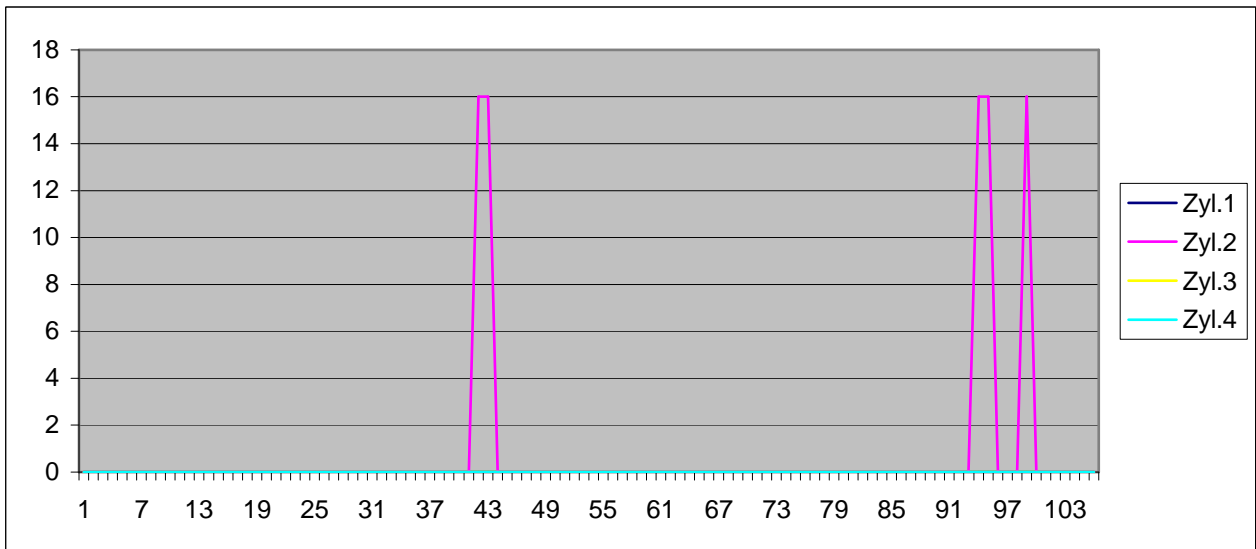

Status 016 - BIP ausserhalb Regelfenster - Zyl.1,3 u.4 = 0 !!